

MODULO D'ORDINE BTE

Soggetto a modifiche ed errori. Il colore può variare in base alla stampa.

MITTENTE

AUDIOPROTESISTA DI RIFERIMENTO:

CODICE UTENTE

N°

Età	Sostituzione	Prima applicazione	
	Destro <input type="checkbox"/> Sinistro <input type="checkbox"/>	Destro <input type="checkbox"/>	Sinistro <input type="checkbox"/>

NOTE

APPARECCHIO ACUSTICO

PRODOTTO	Mood G2	Rixx G2	XS G2	DUO G2
MODELLO	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16
TIPOLOGIA	RIC	RIC	BTE	BTE
Quantità				
Colore standard	Argento	Argento	8/12/16 : Argento 4/6 : Granite/Argento	8/12/16 : Argento 4/6 : Granite/Argento

ALTRO

Telecomando 2.0		-		
Mobile Connect Set		-		
Micro Connect Set		-		
Telecomando G2		-		



PRODOTTO	P G2	HP	Nova 2	Astral 23
MODELLO	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> MINI <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> HP
TIPOLOGIA	BTE	BTE	BTE	BTE
Quantità				
Colore standard	Granite/Argento	Beige	Beige	Beige

ALTRO

Telecomando 2.0		-	-	-
Mobile Connect Set		-	-	-
Micro Connect Set		-	-	-
Telecomando G2		-	-	-

RICEVITORE PER RIC (Mood e Rixx)	DESTRO	Misura <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 45 DB	<input type="checkbox"/> 55/60 DB	<input type="checkbox"/> 60/65/70 DB	Quantità:
	SINISTRO	Misura <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 45 DB	<input type="checkbox"/> 55/60 DB	<input type="checkbox"/> 60/65/70 DB	Quantità:

MODULO D'ORDINE BTE

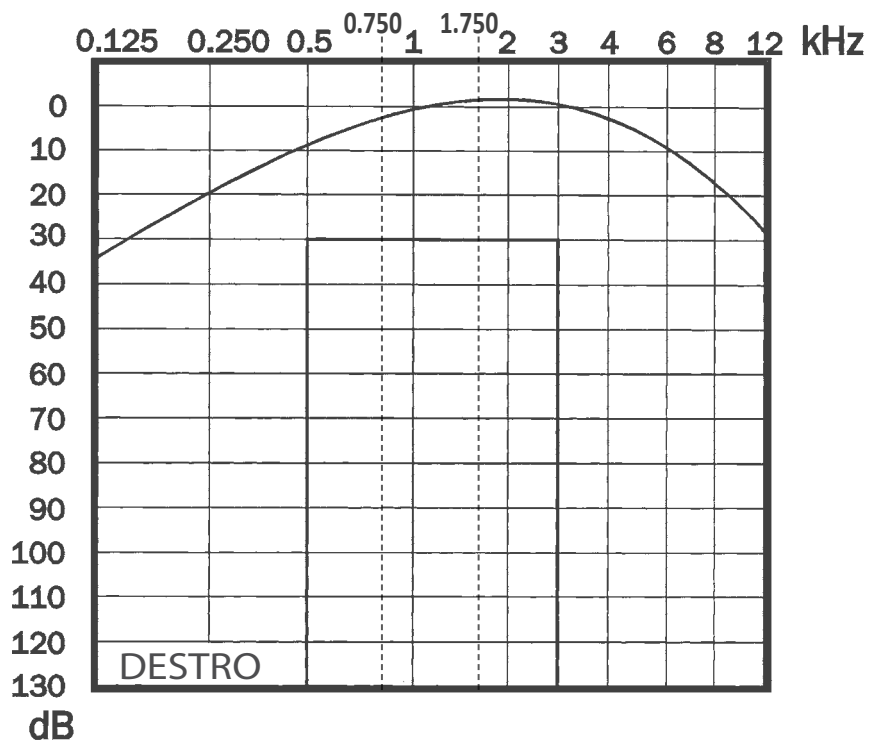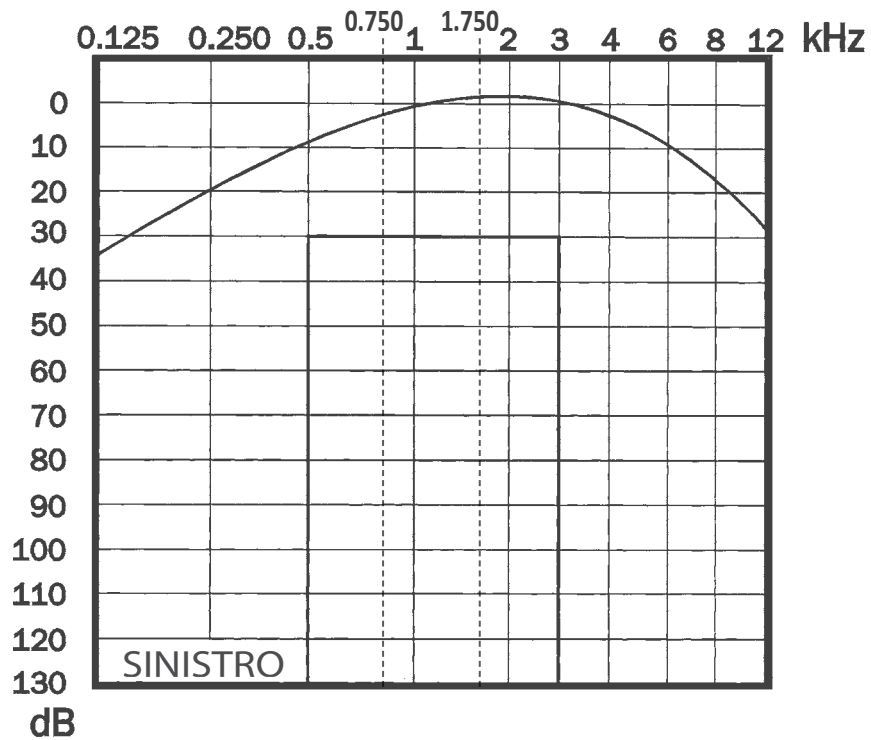

Si prega di compilare l'audiogramma a mano oppure di inviarlo in allegato come pdf o scan.